

政府采购合同格式（货物类）

合同编号: MYZY201812SBCG032-HT

项目名称: 北京市密云区中医医院医疗设备及软件系统项目

货物名称: 纤维输尿管肾镜及附件/硬性输尿管镜及附件（第六包）

买 方: 北京市密云区中医医院

卖 方: 北京海天恒东医疗器械有限公司

签署日期: 2018年12月10日



合 同 书

北京市密云区中医医院 (买方) 北京市密云区中医医院医疗设备及软件系统项目 (项目名称) 中所需 纤维输尿管肾镜及附件/硬性输尿管镜及附件 (货物名称) 经 中经国际招标集团有限公司 (招标采购单位) 以 CEITCL-BJ10-1810009 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 北京海天恒东医疗器械有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物: 纤维输尿管镜及附件, 数量: 2 套

硬性输尿管镜及附件, 数量: 1 套

3、合同总价

本合同总价为: 肆拾玖万玖仟元整 (499,000.00) 元人民币。

分项价格:

纤维输尿管肾镜及附件 2 套 单价: 贰拾万元整 总价: 肆拾万元整

硬性输尿管镜及附件 1 套 单价: 玖万玖仟元整 总价: 玖万玖仟元整

交货地点: 北京市密云区中医医院

4、付款方式

本合同的付款方式为：货到安装验收合格后，付清货款的 50%，试运行三个
月后，经使用科室及管理科室确认后付清其余 50% 货款。

5、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有
的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术
规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

6、知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专
利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，
卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

7、包装要求

7.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进
行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距
离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于
包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

7.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8、装运标志

8.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标
记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____


目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

8.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文

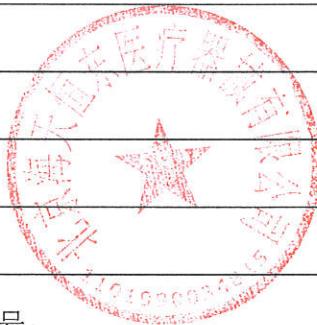

和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

9、交货方式

9.1 交货方式：现场交货，免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

9.2 卖方应在合同规定的交货期3天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

9.3 在现场交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

10、技术资料

10.1 合同项下技术资料(除特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后15天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

11、质量保证

11.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起纤维输尿管肾镜 24 个月、硬性输尿管镜 24 个月。

12、检验和验收

12.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，安装、调试、培训完成后，买方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

12.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

13、索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储

费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14、延迟交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15、违约赔偿

除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16、不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18、合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向买方所在地人民法院提起诉讼。

18.2 诉讼费用应由败诉方负担。

19、违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 15 的规定可以解除合同的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20、破产终止合同

如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。

该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21、转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

22、合同修改

买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26、履约保证金

26.1 卖方应在合同签订后5天内，按约定的方式向买方提交合同总价5%的履约保证金。

26.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

- 26.4 履约保证金在法定的货物质量保证期满前应完全有效。
- 26.5 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

27、合同生效和其它

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2 本合同一式7份，具有同等法律效力。

附件：

- 附件 1——中标通知书
- 附件 2——投标一览表
- 附件 3——投标分项报价表
- 附件 4——货物说明一览表
- 附件 5——技术规格偏离表
- 附件 6——商务条款偏离表
- 附件 7——资格证明文件

- 7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
- 7-2 组织机构代码证的复印件（须加盖本单位公章）
- 7-3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）
- 7-4 法定代表人授权书
- 7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时适用）
- 7-6 经销商（作为代理）的资格声明
- 7-7 制造商的授权书（所投货物为进口货物时适用）

7-8 所投货物的有效期内的注册证及注册登记表或者软件、系统的知识产权证明文件等

附件 8——售后服务承诺书

买 方: _____

名 称: (印章)

2018年12月11日

授权代表(签字): 

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

开户银行: _____

帐 号: _____

卖 方: 北京海天恒东医疗器械有限

公司

名 称: (印章)

2018 年12月11日

授权代表(签字): 

地 址: 北京市门头沟区雁翅镇芹峪

村北 1 号院内西房 2 室 3 室

邮政编码: 102305

电 话: 010-60865908

开户银行: 中国农业银行北京石龙支行

帐 号: 11032101040010389

开户行行号: 103100003215

企业规模: 小型企业





中经国际招标集团有限公司

CHINA ECONOMIC INTERNATIONAL TENDERING CO, LTD

地址：北京市东城区滨河路 1 号航天信息大厦七层
邮编：100013
电话：(86-10) 84228192
传真：(86-10) 68373131

Address: F7, Aerospace Information Plaza, No.1,
Binhe Lu, Dongcheng District, Beijing 100013, P.R.China
Tel: (86-10) 84229192
Fax: (86-10) 68373131

中标通知书

(CEITCL-BJ10-1810009)

北京海天恒东医疗器械有限公司：

中经国际招标集团有限公司在此通知：通过评标委员会对北京市密云区中医医院医疗设备及软件系统项目（招标编号：CEITCL-BJ10-1810009）认真评审和用户确认，贵公司为本项目第六包的中标商。

中标内容：硬性输尿管镜及附件/纤维输尿管肾镜及附件

中标金额：¥499,000.00

根据中华人民共和国政府采购法第四十六条及第七十一条第（五）款的规定，请贵公司在收到本通知书原件后 30 日内与北京市密云区中医医院医疗设备及软件系统项目的相关负责人联系签订政府采购合同，并将其中两份合同纸质原件及一份合同电子文件光盘自合同签订之日起 1 个工作日内送至我公司办理合同备案。

中经国际招标集团有限公司

2018年11月19日

投标一览表

招标编号：CEITCL-BJ10-1810009

项目名称：北京市密云区中医院医疗设备及软件系统项目

序号	设备名称	投标总价(元)	投标保证金	交货时间	备注
1	纤维输尿管肾镜及附件 硬性输尿管镜及附件	肆拾玖万玖仟元整	伍仟元整	合同签订后30天内	



投标人名称（盖章）：北京海天恒东医疗器械有限公司

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。



投标分项报价表

投标人名称: 北京海天恒东医疗器械有限公司

招标编号: CEITCL-BJ10-1810009

报价单位: 人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
1.1	纤维输尿管肾镜及附件	7326071	2	德国 RICHARD WOLF	200,000.00	400,000.00	
1.2	硬性输尿管肾镜及附件	8703.534	1	德国 RICHARD WOLF	99,000.00	99,000.00	
2.	备品备件	无					
3.	专用工具	无					
4.	安装、调试、检验	免费					
5.	培训	免费					
6.	技术服务	免费					
7.	至最终目的地运费				免费		
总价:		肆拾玖万玖仟元整				499,000.00	

投标人授权代表签字: 
 投标人(盖章): 北京海天恒东医疗器械有限公司

- 注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 上述各项的详细分项报价,应另页描述。

货物说明一览表

投标人名称: 北京海天恒东医疗器械有限公司

招标编号: CEITCL-BJ10-1810009

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它
1	纤维输尿管肾镜及附件	直径 6/9. 9Fr (头端 6Fr, 近 2mm, 后端 9. 9Fr, 3mm), 镜体具备两个独立的器械通道, 一个作为激光光纤专用通道, 另一个可进入 3. 3Fr (1mm) 器械, 或利用两个通道进行连续冲洗保持视野清晰。保证手术中可同时进入激光碎石光纤和取石器械, 镜体工作长度 680mm, 头端可上弯 270 度, 下弯 270 度, 并可多段分节弯曲	2	合同签订后 30 天内	院方指定地点	无
2	硬性输尿管及附件	直径 8/9. 8Fr, 12 度, 工作长度 430mm	1	合同签订后 30 天内	院方指定地点	无

投标人授权代表签字:

投标人(盖章): 北京海天恒东医疗器械有限公司

注: 各项货物详细技术性能参数另页描述。



技术规格偏离表

投标人名称: 北京海天恒东医疗器械有限公司 招标编号: CEITCL-BJ10-1810009
 包号: 6

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1	纤维输尿管肾镜	1.1	用于输尿管及肾盂的检查及碎石治疗, 适用于激光碎石的使用	用于输尿管及肾盂的检查及碎石治疗, 适用于激光碎石的使用	无偏离	详见产品彩页
2	纤维输尿管肾镜	1.2	配置包括纤维镜体、激光光纤伸缩及固定旋钮接口、测漏接口、气体消毒平衡阀, 清洗刷、及手提箱	配置包括纤维镜体、激光光纤伸缩及固定旋钮接口、测漏接口、气体消毒平衡阀, 清洗刷、及手提箱	无偏离	详见产品彩页
3	纤维输尿管肾镜	1.3	镜体工作长度680mm, 头端直径6Fr, 后端直径9.9Fr	镜体工作长度680mm, 头端直径6Fr, 后端直径9.9Fr	无偏离	详见产品彩页
4	纤维输尿管肾镜	#1.4	镜体后端具有激光光纤操纵旋钮, 可控制激光光纤伸缩5mm, 并在不使用时将光纤固定于器械通道内	镜体后端具有激光光纤操纵旋钮, 可控制激光光纤伸缩5mm, 并在不使用时将光纤固定于器械通道内	无偏离	详见产品彩页
5	纤维输尿管肾镜	#1.5	镜体具备两个独立的器械通道, 一个作为激光光纤专用通道, 另一个可进入3.9Fr器械, 或利用两个通道进行连续冲洗保持视野清晰。保证手术中可同时进入激光碎石光纤和取石器械	镜体具备两个独立的器械通道, 一个作为激光光纤专用通道, 另一个可进入3.9Fr器械, 或利用两个通道进行连续冲洗保持视野清晰。保证手术中可同时进入激光碎石光纤和取石器械	无偏离	详见产品彩页

6	纤维输尿管肾镜	1.6	视向角：0 度，视野角 ≥ 85 度	视向角：0 度，视野角 85 度	无偏离	详见产品彩页
7	纤维输尿管肾镜	#1.7	头端可上弯 ≥ 270 度，下弯 ≥ 270 度，并可多段分节弯曲。	头端可上弯 270 度，下弯 270 度，并可多段分节弯曲。	无偏离	详见产品彩页
8	纤维输尿管肾镜	1.8	活检阀套装：3-5FR	活检阀套装：3-5FR	无偏离	详见产品彩页
9	纤维输尿管肾镜	1.9	活栓，带 luer 接头	活栓，带 luer 接头	无偏离	详见产品彩页
10	硬性输尿管镜	1	外径 8/9.8Fr，工作长度 ≥ 430 mm	外径 8/9.8Fr，工作长度 430mm	无偏离	详见产品彩页
11	硬性输尿管镜	2	视向角 $\geq 12^\circ$	视向角 12°	无偏离	详见产品彩页
12	硬性输尿管镜	3	器械通道 ≥ 5 Fr	器械通道 5Fr	无偏离	详见产品彩页
13	硬性输尿管镜	4	适用于激光、液电、超声及气压弹道等碎石手术	适用于激光、液电、超声及气压弹道等碎石手术	无偏离	详见产品彩页
14	硬性输尿管镜	5	可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，消毒温度 $\geq 134^\circ\text{C}$	可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，消毒温度 134°C	无偏离	详见产品彩页
15	硬性输尿管镜	6	镜子前端凸起设计	镜子前端凸起设计	无偏离	详见产品彩页
16	硬性输尿管镜	7	配备数字式蓝宝石镜头	配备数字式蓝宝石镜头	无偏离	详见产品彩页
17	硬性输尿管镜	8	镜体与器械通道一体式设计	镜体与器械通道一体式设计	无偏离	详见产品彩页

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：北京海天恒东医疗器械有限公司



商务条款偏离表

北京海天恒东医疗器械有限公司 招标编号: CEITCL-BJ10-1810009

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1	六. 5	投标保证金: 5000 元	投标保证金: 5000 元	无偏离
	六. 5	投标保证金递交截止时间: 2018 年 11 月 15 日 15 时 30 分前	投标保证金递交截止时间: 2018 年 11 月 15 日 15 时 30 分前	无偏离
2	六. 7	投标有效期 90 日历	投标有效期 90 日历	无偏离
3	六. 8	*投标文件一式 7 份，其中正本 1 份，副本 5 份，电子版 1 份	*投标文件一式 7 份，其中正本 1 份，副本 5 份，电子版 1 份	无偏离
4	七. 1	货物安装和运行地点位于: 北京市密云区中医医院指定	货物安装和运行地点位于: 北京市密云区中医医院指定	无偏离
5	七. 2	货物交货方式为: 免费上门送货、安装、调试	货物交货方式为: 免费上门送货、安装、调试	无偏离
4	七. 3	交货时间: 合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试	交货时间: 合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试	无偏离
5	七. 4	付款方式: 货到安装验收合格后, 付清货款的 50%, 试运行三个月后付清其余 50% 货款。	付款方式: 货到安装验收合格后, 付清货款的 50%, 试运行三个月后付清其余 50% 货款。	无偏离
6	七. 10	提交履约保证金时间: 签订合同后 5 日内。履约保证金金额: 合同总价的 5%。	提交履约保证金时间: 签订合同后 5 日内。履约保证金金额: 合同总价的 5%。	无偏离
7	八. 6	保修期: ≥ 36 个月	保修期: 纤维输尿管肾镜 24 个月 硬性输尿管镜 24 个月	负偏离

投标人授权代表签字:



投标人(盖章):

编号: 104410530

营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101090672843276

名称 北京海天恒东医疗器械有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房2室3室
法定代表人 李书元
注册资本 200万元
成立日期 2013年04月28日
营业期限 2013年04月28日至2043年04月27日
经营范围 销售第三类医疗器械;销售医疗器械(I类、II类)、苗木、办公设备、消防用具、体育用品、仪器仪表、建筑装饰材料、五金交电、机械设备、化工产品(除化学危险品和一类易制毒化学品);会议服务;商务服务;机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上年度年度报告并公示。

2018

年 07 月 11 日

北京市工商行政管理局 监管

企业信用信息公示系统网址:

qyxy.bjic.gov.cn

医疗器械经营许可证

企业名称：北京海天恒东医疗器械有限公司
经营方式：批发

许可证编号：京门食药监械经营许20170016号

法定代表人：李书元

企业负责人：

李书元

经营场所：北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房2室3室
库房地址：北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房1室2室3室4室5室
经营场所：北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房6室、南房1室2室

6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，
6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，
6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试和除外），
6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，
6866医用高分子材料及制品，6877介入器材***

2017年09月18日

有效期至：2022年09月17日发证部门：

北京市门头沟区食品药品监督管理局

国家食品药品监督管理总局制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：京门食药监械经营备20170028号

企业名称	北京海天恒东医疗器械有限公司
法定代表人	李书元
企业负责人	李书元
经营方式	批发
住所	北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房2室3室
经营场所	北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房1室2室3室4室5室
库房地址	北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房6室、南房1室2室
经营范围	II类：6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6830医用X射线设备，6831医用X射线附属设备及部件，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6841医用化验和基础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855消毒和灭菌设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870敷料

备案日期：2017年09月15日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中国的北京海天恒东医疗器械有限公司的在下面签字的李书元
总经理 代表本公司授权北京海天恒东医疗器械有限公司的在下面签字的单丹丹 业务经理
为本公司的合法代理人，就北京市密云区中医医院医疗设备及软件系统项目的纤维输尿管
肾镜及附件、硬性输尿管镜及附件投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2018 年 11 月 7 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字 李书元

被授权人签字 _____

公司盖章



附：

被授权人姓名：单丹丹

职 务：业务经理

详细通讯地址：北京市丰台区长辛店太子峪白草洼 200 号

邮政编码：100072

传 真：010-60865908

电 话：13241339265



附件7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时适用）

1、名称及概况：

(1) 制造商名称： Richard Wolf GmbH

(2) 地址及邮编： Pforzheimer str.32,D-75438 Knittlingen

(3) 成立和注册日期： 1947

(4) 主管部门： _____

(5) 企业性质： 外企

(6) 法人代表： Alfons Notheis

(7) 职员人数： 1100

一般工人： _____

技术人员： _____

(8) 近期资产负债表(到_____年_____月_____日止)

(1) 固定资产： 保密

原值： 保密

净值： 保密

(2) 流动资金： 保密

(3) 长期负债： 保密

(4) 短期负债： 保密

(5) 资金来源

自有资金： 保密

银行贷款： 保密

(6) 资金类型： 保密

生产资金： 保密

非生产资金： 保密

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址 生产的项目

克尼特林根 内窥镜设备

职工人数

1100

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

64年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址	<u>安贞医院</u>	销售项目和数量	<u>摄像系统及内窥镜</u>
	<u>武警总医院</u>		<u>摄像系统及内窥镜</u>
	<u>空军总院</u>		<u>摄像系统及内窥镜</u>

出口销售额: _____

5、近三年的年营业额:

年份	国内	出口	总额
<u>2008 年</u>	<u>3243921300</u>	<u>8111423400</u>	<u>11355344700</u>
<u>2009 年</u>	<u>3226098800</u>	<u>7860306300</u>	<u>11086405100</u>
<u>2010 年</u>	<u>3326790600</u>	<u>9223584900</u>	<u>12550375500</u>

6、有关开户银行的名称和地址: Deutsche Bank AG, Karlsruhe

7、其他情况: _____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: 2011 年 07 月 22 日

制造商名称: RICHARD WOLF GMBH

投标人授权代表(签字): Jureng Pfab

投标人授权代表的职务: 经理

制造商盖章: _____

电话号: +49-7043-35-235

传真号: +49-7043-35-266

传真号: +49-7043-35-266

电话号: +49-7043-35-235



编号: 103550262



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110108673810251C

名 称 北京圣和田医疗设备有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所 北京市海淀区远大路39号1号楼621/622A室
法定代表人 李炳强
注 册 资 本 100万元
成 立 日 期 2008年03月26日
营 业 期 限 2008年03月26日至 2028年03月25日
经 营 范 围 销售医疗器械III类(以《医疗器械经营许可证》核定范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年02月25日); 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 销售机械设备、仪器仪表、医疗器械II类; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2017年06月28日

医疗器械经营许可证

企业名称：北京圣和田医疗设备有限公司

法定代表人：李炳强

经营负责人：陈轶文

经营方式：批发

住所：北京市海淀区远大路39号1号楼521/622A室

经营场所：北京市海淀区远大路39号1号楼521/622A室

库房地址：北京市海淀区远大路39号1号楼521室

许可证编号：京海食药监械经营许20150064号

有效期至：2020年02月25日

发证部门：北京市食品药品监督管理局

日期：2017年01月25日

注：622医用光学器具、仪器及内窥镜设备，623医疗器械设备，624家用医疗器械，625家用医疗器械设备，626家用治疗设备，627家用厨房设备及有关设备，628家用电气设备，629家用电子设备，630手术器械，631敷料、治疗设备及器具，632软件，633医用诊断分析与综合设备及器具。



国家食品药品监督管理总局制



spirit of excellence

Distributor Authorization

Richard Wolf Hong Kong Ltd., Unit 1406, 14/F, Grand Millennium Plaza,
181 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
hereinafter: RW

for

Beijing Surgical & Technology Co., Ltd., 北京圣和田医疗设备有限公司, 622A,
Building 1, NO. 39 Yuanda Road, Haidian District, 100097 Beijing, P.R.C., 北京市海淀区
远大路 39 号 1 号楼 622A 室
hereinafter: Distributor

Hereby RW confirms that the Distributor is exclusively authorized to perform the sales and distribution of Richard Wolf instruments and equipment for medical endoscopy related to the following territories and disciplines:

Province: Beijing

Included disciplines: Urology, Gynecology, General Surgery, ENT, Arthroscopy

Excluded disciplines: core

Excluded products: Li Xun Nephroscope 8968405/8968407, KeyPort Telescopes, KeyPort & KeyPort flex Trocars + Accessories, DuoRotate and InLine instruments and Key Port accessories for laparoscopic (transabdominal) applications only

Hospitals: Selected public hospitals

(limited to the hospitals in Annex 2)

Province: Inner Mongolia

Included disciplines: Urology, Gynecology, General Surgery, ENT, Arthroscopy

Excluded disciplines: core

Excluded products: Li Xun Nephroscope 8968405/8968407, KeyPort Telescopes, KeyPort & KeyPort flex Trocars + Accessories, DuoRotate and InLine instruments and Key Port accessories for laparoscopic (transabdominal) applications only

Hospitals: All public and private hospitals

HK Showroom:

Unit No. 1406

14th Floor of Low Block of Grand Millennium plaza

No. 181 Queen's Road Central

Hong Kong

Tel: +852-2107-3446

Fax: +852-2107-3449

HK Office:

15/F., OTB Building, 160 Gloucester Road,

Hong Kong

Internet: <http://www.richard-wolf.com>

Bank Details:

The HongKong Shanghai Banking Corporation Ltd.

No. 1 Queen's Road Central, Hong Kong

EUR A/C 848-360930-275

Swift code: HSBC HKH HKH

Managing Directors:

Jürgen Steinbeck,

Jürgen Pfab



Page 2 of 2

spirit of excellence

Province: Tianjin

Included disciplines: Urology, Gynecology, General Surgery, ENT, Arthroscopy
Excluded disciplines: cōre

Excluded products: Li Xun Nephroscope 8968405/8968407, KeyPort Telescopes, KeyPort & KeyPort flex Trocars + Accessories, DuoRotate and InLine instruments and Key Port accessories for laparoscopic (transabdominal) applications only
Hospitals: All public and private hospitals

Annex 1 and Annex 2 are integral part of the Distributor Authorization.

The authorization is effective July 6, 2018 and valid until December 31, 2018.

Knittlingen, July 6, 2018
RICHARD WOLF HK LTD.

Jürgen Steinbeck
Managing Director

Knittlingen, July 6, 2018
RICHARD WOLF HK LTD.

Jürgen Pfäb
Managing Director

Annex 1: Duties and Responsibilities

Annex 2: Hospital list Beijing

HK Showroom:
Unit No. 1406
14th Floor of Low Block of Grand Millennium plaza
No. 181 Queen's Road Central
Hong Kong
Tel: +852-2187-3446
Fax: +852-2187-3448

HK Office:
16/F., OTB Building, 160 Gloucester Road,
Hong Kong
Internet: <http://www.richard-wolf.com>

Bank Details:
The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Ltd
No. 1 Queen's Road Central, Hong Kong
EUR A/C B48-369930-276
Swift code: HSBC HKH HHKH

Managing Directors:
Jürgen Steinbeck,
Jürgen Pfäb

投标人的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 投标人名称： 北京海天恒东医疗器械有限公司
(2) 地址及邮编： 北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北 1 号院内西房 2 室 3 室
邮编：102305
(3) 成立和注册日期： 2013 年 4 月 28 日
(4) 主管部门：
(5) 公司性质： 有限责任公司
(6) 法人代表： 李书元
(7) 职员人数： 8
(8) 近期资产负债表(到2017年12月31日止)

<1> 固定资产： 100000 元
 原值：56426 元
 净值：43261 元
<2> 流动资金：298512 元
<3> 长期负债：
<4> 短期负债：
<5> 资金来源：
 自有资金：500000 元
 银行贷款：
<6> 资金类型：
 商业性：是
 非商业性：

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
2015	<u>3753829.1</u>	<u>3753829.1</u>	
2016	<u>8262135.6</u>	<u>8262135.6</u>	
2017	<u>7530126.8</u>	<u>7530126.8</u>	

3、账号及开户银行的名称、地址：中国农业银行北京石龙支行、北京市门头沟区永定镇石龙工业区


4 投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们
同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：2018年11月07日

投标人授权代表(签字)

公章：北京海天恒东医疗器械有限公司

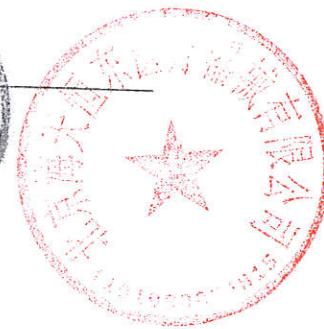

附件7-7 制造厂家的授权书

(所投货物为进口货物时适用)

致: 中经国际招标集团有限公司

我们(北京圣和田医疗器械有限公司)是按(中国)法律成立的一家制造商,主要营业地点设在(北京市海淀区远大路39号1号楼621/622A室)。兹指派按(中国)的法律正式成立的,主要营业地点设在(北京市门头沟区雁翅镇芹峪村北1号院内西房2室3室)的(北京海天恒东医疗器械有限公司)作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动:

- (1) 代表我方办理贵方第 CEITCL-BJ10-1810009 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜,并对我方具有约束力。
- (2) 作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
- (3) 我方兹授予北京海天恒东医疗器械有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换或撤销的全权。兹确认北京海天恒东医疗器械有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
- (4) 我方于 2018 年 11 月 7 日签署本文件。北京海天恒东医疗器械有限公司于 2018 年 11 月 7 日接受此件,以此为证。

制造商名称(盖章) 

签字人职务和部门 经理 市场部

签字人(签字) 

23
2018年11月7日

按照第八章货物技术规格及要求出具的投标人售后服务承诺函

售后服务承诺函

一、质量及技术标准: 本包所有设备按合同书标准执行

二、包装标准及要求: 本包所有设备按原厂包装标准执行

三、验收标准及方法:

1、本设备送货安装后，使用单位也有权按我公司投标文件的标准验收。

2、使用单位有权委托国内有资格的单位对投标设备进行精度校准，商品性能验收以仪器正常运转并按说明书参数要求出据验收报告为准。我公司对此种单方检测或验收结果不持异议。

3、设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

四、货物的培训方案:

1、本设备到货后，我公司按使用单位通知时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试、及试运行，直至设备正常运行。

2、我公司负责对使用单位技术人员、操作人员进行免费培训，培训内容包括设备操作，设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、培训人员名单由使用单位自定。

五、保修及售后服务:

1、**本包设备：**自安装验收合格之日起免费保修 24 个月（人为损坏除外），终身负责维修，保修内容包括组成投标设备的所有零部件；在保修期后，公司与实际使用人协商维修保养事宜。

2、**安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用，我公司无条件换货。**保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，2小时内响应，提出解决方案，8小时内到达现场。

3、为保证设备正常运行，我公司保证备件 10 年以上的供应期，并且在用户地区设有维修站，并且有专业维修人员提供仪器最新信息及应用资料。

4、保修期内，我公司提供免费升级服务，免费升级软件。

5、保修期内，我公司定期回访，保证设备的正常使用。

6、设备保质期结束后，我公司为实际使用方提供终身的维修服务，只收成本费。

六、供货方案:

按用户的要求，协调厂商，确保及时供货：

1、从医院取得科室联系人及联系电话，及时联系，确定具体送货时间。

2、本公司派专人协调厂商送货安装人员，货到后按医院的要求及时将设备安放到指定地点，并进行现场安装、调试。

3、每台(套)产品随机提供一整套技术文件(包含中文说明书、产品合格证、随机原始装箱单等资料)。设备安装、调试完毕，经医院负责人验收合格后，填写验收合格单并签字盖章。

七、售后服务网点、电话：

我公司在北京具有完善的售后服务队伍，及时响应使用方的服务要求，提供7×24小时服务响应。

1. 售后服务网点：北京市海淀区远大路西口青清商厦 622A

电话：010-88864609, 88864429

传真：010-88864429-608

投标人（盖章）：北京海天恒东医疗器械有限公司

投标人授权代表（签字）：单丹

日期：2018年11月7日



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20153220369

注册人名称	Richard Wolf GmbH
注册人住所	Pforzheimer Strasse 32, D-75438 Knittlingen
生产地址	Pforzheimer Strasse 32, D-75438 Knittlingen
代理人名称	北京德华信达技术有限公司
代理人住所	北京市海淀区清河镇小营地区鼎嘉恒苑小区商业楼3层3-52
产品名称	纤维输尿管肾镜 FIBER URETERO-RENOSCOPE
型号、规格	详见附页
结构及组成	该产品由纤维输尿管肾镜组成。
适用范围	该产品可用于对患者肾脏进行内窥镜检查。
附件	注册产品标准
其他内容	/
备注	

审批部门：国家食品药品监督管理总局 批准日期：二〇一五年五月十六日
有效期至：二〇二〇年四月十五日

8703.524	纤维输尿管肾镜，侧偏置目镜，工作长度 430mm，最大插入部外径 3.3mm，最小器械孔道内径 1mmX1.7mm	181000
8703.534	纤维输尿管肾镜，偏置目镜，工作长度 430mm，最大插入部外径 3.3mm，最小器械孔道内径 1mmX1.7mm	181000
8704.524	纤维输尿管肾镜，工作长度 430mm，最大插入部外径 3.8mm，最小器械孔道内径 1.3mmX2mm	181000
8703.534	纤维输尿管肾镜，工作长度 430mm，最大插入部外径 2.8mm，最小器械孔道内径 0.85mmX1.3mm	181000

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20162222827

注册人名称	RichardWolfGmbH
注册人住所	Pforzheimer Strasse32, D-75438 Knittlingen
生产地址	Pforzheimer Strasse32, D-75438 Knittlingen
代理人名称	北京德华信达技术有限公司
代理人住所	北京市海淀区后屯南路26号3层3-52
产品名称	纤维输尿管肾镜及附件 Flexible ureterorenoscopes and Accessories
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品由纤维输尿管肾镜、密封阀、紧固件、转接器、活组织取样阀、橡胶盖、封帽、冷光源连接器、导光束、钳子和电极组成，其中内窥镜由柔性导入鞘，带调整杆（带内置0度定位和制动杆）和目镜，带图像传导纤维和冷光源接头，带两个鲁尔接头的工作通道，带单独的激光光纤通道，带调整单元和清洗转接头。
适用范围	该产品主要用于通过自然通道观察人体内腔和器官，和内窥镜附件配套用于泌尿科尿道、膀胱和肾的检查和治疗。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：

国家食品药品监督管理总局

批准日期：

二〇一六年九月十八日

有效期至：

二〇二〇年九月十七日



型号规格:

序号	型号规格
7326071	纤维输尿管肾镜，双通道，连续冲洗，工作通道 1.2mm，激光光纤通道 1.1mm；推向远端向下
7326076	纤维输尿管肾镜，双通道，连续冲洗，工作通道 1.2mm，激光光纤通道 1.1mm；推向远端向上
15114068	密封阀，蓝色/透明，每包 20 只；一次性用品
15394.144	紧固件，橘色（用于紧固激光纤维），每包 20 个；一次性用品
7305.782	转接器
7265.851	活组织取样阀
88.01	橡胶盖
887.00	封帽
8095.00	冷光源连接器
8061.253	导光束，纤维束直径 2.5mm，总长 2.3m
828.651	柔性异物抓钳，工作长度 950mm，直径 3 Fr.，钳嘴张角 60°，开口长度 5.6mm
829.601	柔性活检钳，工作长度 950mm，直径 3 Fr.，钳嘴张角 90°，开口长度 3.2mm
8741.80	软性纽扣电极，工作长度 920mm，直径 3 Fr.

