

政府采购合同格式（货物类）

合同编号： MYZY201902SBCG002-HT

项目名称： 北京市密云区中医医院医疗设备采购项目

货物名称： 动态心电分析系统、动态血压检测系统（第二包）

买 方： 北京市密云区中医医院

卖 方： 北京胜云心康医疗科技有限公司

签署日期： 2019 年 02 月 27 日



合 同 书

北京市密云区中医医院 (买方) 北京市密云区中医医院医疗设备采购项目 (项目名称) 中所需 动态心电分析系统、动态血压检测系统 (货物名称) 经 中经国际招标集团有限公司 (招标采购单位) 以 CEITCL-BJ10-1901009 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 北京胜云心康医疗科技有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

第一条 产品名称、规格型号、数量和价格

序号	产品全称	商标牌号	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
1	动态血压检测系统	SunTech	Oscar2	美国	套	1	269,700.00 元	269,700.00 元
2	动态心电分析系统	GE	SEER12	德国	套	1	299,700.00 元	299,700.00 元

第二条 交货时间、地点和交货方式

- 1、交货时间: 合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试。
- 2、交货地点: 北京市密云区中医医院指定。
- 3、交货方式: 现场交货, 免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险,

将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

第三条 付款方式

- 1、产品总价（人民币）：569,400.00 万元（大写：伍拾陆万玖仟肆佰元整）
- 2、货到安装验收合格后，付清货款的50%，试运行三个月后，经使用科室及管理科室确认后付清其余50%货款。

第四条 包装要求和装运标志

- 1、除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
- 2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
- 3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。

第五条 知识产权和质量保证

- 1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。
- 4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
- 5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在

缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 48 个月。

第六条 测试和验收

1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。

2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医疗设备科、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求供应商折价处理的权利。

第七条 违约赔偿

1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物交货价的 0.1% 向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。

2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内索赔，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第八条 不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第九条 质保金

提交质保金时间：签订合同后 7 日内；质保金保证金金额：合同总价的 5%；质保期后，设备运行无任何质量问题退回所有质保金。

第十条 合同争议的解决

因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向买方当地人民法院提起诉讼。

第十一条 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效和其它

- 1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
- 2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义
- 3、本合同一式 7 份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，代理机构贰份，具有同等法律效力。
- 4、本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

备注：

卖方企业规模：☐大型企业/☐中型企业/☐小型企业/☒微型企业

（请卖方根据公司实际情况在□内打√）

附件：

附件 1——中标通知书

附件 2——投标一览表

附件 3——投标分项报价表

附件 4——货物说明一览表

附件 5——技术规格偏离表

附件 6——商务条款偏离表

附件 7——资格证明文件

7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

7-2 组织机构代码证的复印件（须加盖本单位公章）

7-3 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 法定代表人授权书

7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时适用）

7-6 经销商（作为代理）的资格声明

7-7 制造商的授权书（所投货物为进口货物时适用）

7-8 所投货物的有效期内的注册证及注册登记表或者软件、系统的知识产权证明文件等

附件 8——售后服务承诺书

买 方：_____

名 称：（印章）

2019年2月27日

授权代表（签字）：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

卖 方：_____

名 称：（印章）

2019年02月27日

授权代表（签字）：_____

地址：北京市石景山区万广场 D 座 805 室

邮政编码：100043

电 话：010-68656799

开户银行：中信银行石景山支行

帐 号：8110701013100691784

开户行行号：302100011745



中经国际招标集团有限公司

CHINA ECONOMIC INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD

地址：北京市东城区滨河路1号航天信息大厦10-11层

Address: F10-11, Aerospace Information Plaza, No.1,

邮编：100013

Binhelu, Dongcheng District, Beijing 100013, P.R.China

电话：(86-10) 84228192

Tel: (86-10) 84228192

传真：(86-10) 68373131

Fax: (86-10) 68373131

中标通知书

(CEITCL-BJ10-1901009)

北京胜云心康医疗科技有限公司：

中经国际招标集团有限公司在此通知：通过评标委员会对北京市密云区中医医院医疗设备采购项目（招标编号：CEITCL-BJ10-1901009）认真评审和用户确认，贵公司为本项目第二包中标商。

中标内容：动态心电分析系统/动态血压检测系统

中标金额：¥569,400.00

根据中华人民共和国政府采购法第四十六条及第七十一条第（五）款的规定，请贵公司在收到本通知书原件后30日内与北京市密云区中医医院医疗设备采购项目的相关负责人联系签订政府采购合同，并将其中两份合同纸质原件及一份合同电子文件光盘自合同签订之日起1个工作日内送至我公司办理合同备案。

中经国际招标集团有限公司

2019年02月20日



附件2 投标一览表

招标编号: CEITCL-BJ10-1901009		项目名称: 北京市密云区中医医院医疗设备采购项目			
序号	设备名称	投标总价 (元)	投标保证金	交货时间	备注
1	动态血压检测系统	569,400.00 元	5,000.00 元	签订合同后 20 天内	无
2	动态心电图分析系统				无

投标人名称 (盖章): _____

投标人授权代表 (签字): _____

注: 1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中, 每包的投标总价应和附件 3 中的总价相一致。



附件3 投标分项报价表1

投标人名称:北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号: CEITCL-BJ10-1901009

报价单位: 人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价	备注
1.	主机和标准附件	Oscar 2	15	美国	17980.00 元	269,700.00 元	
2.	备品备件				0.00	0.00	
3.	专用工具				0.00	0.00	
4.	安装、调试、检验				0.00	0.00	
5.	培训				0.00	0.00	
6.	技术服务				0.00	0.00	
7.	至最终目的地运费				0.00	0.00	
总价						269,700.00 元	

投标人授权代表签字 杨洋

投标人(盖章):



- 注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

附件3 投标分项报价表1-1

投标人名称:北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号: CEITCL-BJ10-1901009

					报价单位: 人民币元		
序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价	备注
1.	主机	Oscar 2	15	美国	16410.00 元	246,150.00 元	
2.	袖带	Oscar 2	15	美国	1,200.00 元	18,000.00 元	
3.	盒套	Oscar 2	15	美国	370.00 元	5,550.00 元	
4.	操作系统	Oscar 2	1	美国	0.00	0.00	赠送
5.	备品备件				0.00	0.00	
6.	专用工具				0.00	0.00	
7.	安装、调试、检验				0.00	0.00	
8.	培训				0.00	0.00	
9.	技术服务				0.00	0.00	
10.	至最终目的地运费				0.00	0.00	
总价						269,700.00 元	

投标人授权代表签字  投标人(盖章):

- 注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

附件3 投标分项报价表2

投标人名称:北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号: CEITCL-BJ10-1901009

					报价单位: 人民币元		
序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价	备注
1.	主机和标准附件	SEER 12	15	德国	19,980.00 元	299,700.00 元	
2.	备品备件				0.00	0.00	
3.	专用工具				0.00	0.00	
4.	安装、调试、检验				0.00	0.00	
5.	培训				0.00	0.00	
6.	技术服务				0.00	0.00	
7.	至最终目的地运费				0.00	0.00	
总价						299,700.00 元	

投标人授权代表签字 杨修
 投标人(盖章): 

- 注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

附件3 投标分项报价表2-1

投标人名称:北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号: CEITCL-BJ10-1901009

报价单位: 人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价	备注
1.	主机和标准附件	SEER 12	15	德国	17,980.00 元	269,700.00 元	
2.	导联线	SEER 12	15	德国	1500.00 元	22,500.00 元	
3.	盒套	SEER 12	15	德国	500.00 元	7,500.00 元	
4.	操作系统				0.00	0.00	赠送
5.	备品备件				0.00	0.00	
6.	专用工具				0.00	0.00	
7.	安装、调试、检验				0.00	0.00	
8.	培训				0.00	0.00	
9.	技术服务				0.00	0.00	
10.	至最终目的地运费				0.00	0.00	
总价						299,700.00 元	

投标人授权代表签字

投标人(盖章):



注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价,将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价,应另页描述。

附件4 货物说明一览表

投标人名称：北京胜云心康医疗科技有限公司 招标编号：CEITCL-BJ10-1901009

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它
1	动态血压检测系统	0=car 2	15	签订合同二十天内	密云区中医医院指定	无
2	动态心电图分析系统	SEER 12	15	签订合同二十天内	密云区中医医院指定	无

投标人授权代表签字： 柳丹
 投标人(盖章)： 
 注：各项货物详细技术性能应用描述。

附件5. 技术规格偏离表

投标人名称：_北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号：_CEITCL-BJ10-1901009_ 包号：第2包

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明
一	动态心电图分析系统	1.	记录盒：15个	记录盒：15个	无偏离	
		1.1	原装12导联记录盒	原装12导联记录盒	无偏离	
		#1.2	记录盒采样率 $\geq 1,024$ Hz，频响范围0.05-120Hz。	记录盒采样率1,024 Hz，频响范围0.05-120Hz。	无偏离	
		1.3	一节5号碱性电池支持12导联记录器连续记录 ≥ 36 小时。	一节5号碱性电池支持12导联记录器连续记录 ≥ 36 小时。	无偏离	
		1.4	内置起搏器分析功能，独立起搏记录通道，全通道分析。	内置起搏器分析功能，独立起搏记录通道，全通道分析。	无偏离	
		1.5	连接患者后可自动探测波形自动启动，也可手动启动。	连接患者后可自动探测波形自动启动，也可手动启动。	无偏离	
		2	模板分析功能	模板分析功能	无偏离	
		2.1;	模板分析功能：模板数目自适应，根据病人实际波形逐条分析、进行模板分类，非固定模板数。	模板分析功能：模板数目自适应，根据病人实际波形逐条分析、进行模板分类，非固定模板数。	无偏离	
		2.2	详细模板分类：模板类型 ≥ 14 种，包括：干扰波形，起搏器模板，差异性传导，束支阻滞，逸搏，室性，室上性等模板。	详细模板分类：模板类型 ≥ 14 种，包括：干扰波形，起搏器模板，差异性传导，束支阻滞，逸搏，室性，室上性等模板。	无偏离	
		2.3	具有模板融合功能，可合并相似的模版。	有模板融合功能，可合并相似的模版。	无偏离	
		#2.4	具有模板再拆分功能	有模板再拆分功能	无偏离	
		#2.5	具有模板再分析功能，	有模板再分析功能，通	无偏离	

			通过模版内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分。	过模版内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分。		
		3.	房早分析：可通过编辑器根据 N-N 间期有比例的直方图及配合同步条图确定每个病人提前量，随时修正分析结果。	房早分析：可通过编辑器根据 N-N 间期有比例的直方图及配合同步条图确定每个病人提前量，随时修正分析结果。	无偏离	
		4.	房颤、房扑等分析	房颤、房扑等分析	无偏离	
		4.1	同屏同步显示趋势图、直方图、条图等功能，可手工快速查找房颤的起点与终点，并采用区域划分的方法做阵发性房颤及房扑的分析，并可用于编辑某一时段出现的伪差；	同屏同步显示趋势图、直方图、条图等功能，可手工快速查找房颤的起点与终点，并采用区域划分的方法做阵发性房颤及房扑的分析，并可用于编辑某一时段出现的伪差；	无偏离	
		4.2	具有自动检测房颤功能。	具有自动检测房颤功能。	无偏离	
		5.	ST 段分析	ST 段分析	无偏离	
		5.1	波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，可调整 E 点、J 点、J 后点的位置。	波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，可调整 E 点、J 点、J 后点的位置。	无偏离	
		5.2	ST 段分析波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，最大分辨率 $\geq ?$ （用户补充）；最大分辨率 ST 段扫描时间 ≥ 15 秒。	ST 段分析波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，最大分辨率 $\geq ?$ （用户补充）；最大分辨率 ST 段扫描时间 ≥ 15 秒。	无偏离	
		6.	起搏器分析	起搏器分析	无偏离	
		6.1	起搏分析：根据起搏参数可统计出“捕获失灵、输出失灵、感知过度、感知低下”。	起搏分析：根据起搏参数可统计出“捕获失灵、输出失灵、感知过度、感知低下”。	无偏离	
		6.2	所有记录盒内置起搏器分析功能，3+1 通道	所有记录盒内置起搏器分析功能，3+1 通道显示，专用起搏通道显	无偏离	

			显示, 专用起搏通道显示。	示。		
		7.	条图编辑功能: 可进行自动波形扫描。	条图编辑功能: 可进行自动波形扫描。	无偏离	
		8.	事件分析及定义	事件分析及定义	无偏离	
		#8.1	具有 N-N 延迟事件定义功能, 可区分停搏及传导阻滞事件, 对完全不同的房室传导阻滞可快速检出。	具有 N-N 延迟事件定义功能, 可区分停搏及传导阻滞事件, 对完全不同的房室传导阻滞可快速检出。	无偏离	
		8.2	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义 R-R 及 N-N 间期快速统计所有相关事件。	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义 R-R 及 N-N 间期快速统计所有相关事件。	无偏离	
		9.	分析报告: 支持 ≥ 20 种报告格式; 也可由医生自定义报告格式; 可选择预设的多种报告生成系统。	分析报告: 支持 ≥ 20 种报告格式; 也可由医生自定义报告格式; 可选择预设的多种报告生成系统。	无偏离	
		10.	软件系统	软件系统	无偏离	
		#10.1	12 导同步分析及测量: 包括 P-R 间期、Q-T 间期、P 轴及 QRS 电轴的测量, 以及详细的 12 导诊断分析报告, 同时提供各种测量结果的趋势图分析。(提供技术白皮书证实)。	12 导同步分析及测量: 包括 P-R 间期、Q-T 间期、P 轴及 QRS 电轴的测量, 以及详细的 12 导诊断分析报告, 同时提供各种测量结果的趋势图分析。(提供技术白皮书证实)。	无偏离	
		10.2	12 导 ST 段分析: 包括 J 后点 40, 60, 80ms 的测量和趋势分析。	12 导 ST 段分析: 包括 J 后点 40, 60, 80ms 的测量和趋势分析。	无偏离	
		10.3	具备自动分析报告打印功能。	具备自动分析报告打印功能。	无偏离	
		10.4	具备 QT/QTc 自动测量值。	具备 QT/QTc 自动测量值。	无偏离	
		10.5	图像工作站: 1 套	图像工作站: 1 套	无偏离	

		10.5.1	CPU : Intel 酷睿 i3-6100 或以上	CPU : Intel 酷睿 i3-6100 或以上	无偏离	
		10.5.2	内存 $\geq$ 4G, 硬盘 $\geq$ 1000G	内存 $\geq$ 4G, 硬盘 $\geq$ 1000G	无偏离	
		10.5.3	彩色液晶监视器 $\geq$ 20 吋	彩色液晶监视器 $\geq$ 20 吋	无偏离	
		10.5.4	彩色激光打印机: 1 台	彩色激光打印机: 1 台	无偏离	
		10.5.5	提供联入医院 pacs 接口的费用	提供联入医院 pacs 接口的费用	无偏离	
		10.5.6	操作系统: 正版 win7 专业版 64bit	操作系统: 正版 win7 专业版 64bit	无偏离	
		11.	质保期: $\geq$ 48 个月	质保期: $\geq$ 48 个月	无偏离	
二	动态血压检测系统	1.	记录盒: 15 个	记录盒: 15 个	无偏离	
		1.1	原装 12 导联记录盒	原装 12 导联记录盒	无偏离	
		#1.2	记录盒采样率 $\geq$ 1,024 Hz, 频响范围 0.05-120Hz。	记录盒采样率 $\geq$ 1,024 Hz, 频响范围 0.05-120Hz。	无偏离	
		1.3	一节 5 号碱性电池支持 12 导联记录器连续记录 $\geq$ 36 小时。	一节 5 号碱性电池支持 12 导联记录器连续记录 $\geq$ 36 小时。	无偏离	
		1.4	内置起搏器分析功能, 独立起搏记录通道, 全通道分析。	内置起搏器分析功能, 独立起搏记录通道, 全通道分析。	无偏离	
		1.5	连接患者后可自动探测波形自动启动, 也可手动启动。	连接患者后可自动探测波形自动启动, 也可手动启动。	无偏离	
		2.	模板分析功能	模板分析功能	无偏离	
		2.1;	模板分析功能: 模板数目自适应, 根据病人实际波形逐条分析、进行模板分类, 非固定模板数。	模板分析功能: 模板数目自适应, 根据病人实际波形逐条分析、进行模板分类, 非固定模板数。	无偏离	
		2.2	详细模板分类: 模板类型 $\geq$ 14 种, 包括: 干扰波形, 起搏器模板, 差异性传导, 束支	详细模板分类: 模板类型 $\geq$ 14 种, 包括: 干扰波形, 起搏器模板, 差异性传导, 束支	无偏离	

			阻滞，逸搏，室性，室上性等模板。	阻滞，逸搏，室性，室上性等模板。		
		2.3	具有模板融合功能，可合并相似的模版。	具有模板融合功能，可合并相似的模版。	无偏离	
		#2.4	具有模板再拆分功能	具有模板再拆分功能	无偏离	
		#2.5	具有模板再分析功能，通过模版内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分。	具有模板再分析功能，通过模版内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分。	无偏离	
		3.	房早分析：可通过编辑器根据 N-N 间期有比例的直方图及配合同步条图确定每个病人提前量，随时修正分析结果。	房早分析：可通过编辑器根据 N-N 间期有比例的直方图及配合同步条图确定每个病人提前量，随时修正分析结果。	无偏离	
		4.	房颤、房扑等分析	房颤、房扑等分析	无偏离	
		4.1	同屏同步显示趋势图、直方图、条图等功能，可手工快速查找房颤的起点与终点，并采用区域划分的方法做阵发性房颤及房扑的分析，并可用于编辑某一时段出现的伪差；	同屏同步显示趋势图、直方图、条图等功能，可手工快速查找房颤的起点与终点，并采用区域划分的方法做阵发性房颤及房扑的分析，并可用于编辑某一时段出现的伪差；	无偏离	
		4.2	具有自动检测房颤功能。	具有自动检测房颤功能。	无偏离	
		5.	ST 段分析	ST 段分析	无偏离	
		5.1	波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，可调整 E 点、J 点、J 后点的位置。	波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，可调整 E 点、J 点、J 后点的位置。	无偏离	
		5.2	5.2 ST 段分析波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，最大分辨率 $\geq ?$ （用户补充）；最大分辨率 ST 段扫描时间 ≥ 15 秒。	5.2 ST 段分析波形测量软件可实现高分辨率 ST 段分析，最大分辨率 $\geq ?$ （用户补充）；最大分辨率 ST 段扫描时间 ≥ 15 秒。	无偏离	
		6.	起搏器分析	起搏器分析	无偏离	
		6.1	起搏分析：根据起搏参数可统计出“捕获失灵、输出失灵、感知过	起搏分析：根据起搏参数可统计出“捕获失灵、输出失灵、感知过	无偏离	

			度、感知低下”。	度、感知低下”。		
		6.2	所有记录盒内置起搏器分析功能, 3+1 通道显示, 专用起搏通道显示。	所有记录盒内置起搏器分析功能, 3+1 通道显示, 专用起搏通道显示。	无偏离	
		7.	条图编辑功能: 可进行自动波形扫描。	条图编辑功能: 可进行自动波形扫描。	无偏离	
		8.	事件分析及定义	事件分析及定义	无偏离	
		#8.1	具有 N-N 延迟事件定义功能, 可区分停搏及传导阻滞事件, 对完全不同的房室传导阻滞可快速检出。	具有 N-N 延迟事件定义功能, 可区分停搏及传导阻滞事件, 对完全不同的房室传导阻滞可快速检出。	无偏离	
		8.2	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义 R-R 及 N-N 间期快速统计所有相关事件。	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义 R-R 及 N-N 间期快速统计所有相关事件。	无偏离	
		9.	分析报告: 支持 ≥ 20 种报告格式; 也可由医生自定义报告格式; 可选择预设的多种报告生成系统。	分析报告: 支持 ≥ 20 种报告格式; 也可由医生自定义报告格式; 可选择预设的多种报告生成系统。	无偏离	
		10.	软件系统	软件系统	无偏离	
		#10.1	12 导同步分析及测量: 包括 P-R 间期、Q-T 间期、P 轴及 QRS 电轴的测量, 以及详细的 12 导诊断分析报告, 同时提供各种测量结果的趋势图分析。(提供技术白皮书证实)。	12 导同步分析及测量: 包括 P-R 间期、Q-T 间期、P 轴及 QRS 电轴的测量, 以及详细的 12 导诊断分析报告, 同时提供各种测量结果的趋势图分析。(提供技术白皮书证实)。	无偏离	
		10.2	12 导 ST 段分析: 包括 J 后点 40, 60, 80ms 的测量和趋势分析。	12 导 ST 段分析: 包括 J 后点 40, 60, 80ms 的测量和趋势分析。	无偏离	
		10.3	具备自动分析报告打印功能。	具备自动分析报告打印功能。	无偏离	

		10.4	具备 QT/QTc 自动测量值。	具备 QT/QTc 自动测量值。	无偏离	
		10.5	图像工作站：1 套	图像工作站：1 套	无偏离	
		10.5.1	CPU：Intel 酷睿 i3-6100 或以上	CPU：Intel 酷睿 i3-6100 或以上	无偏离	
		10.5.2	内存 $\geq$ 4G, 硬盘 $\geq$ 1000G	内存 $\geq$ 4G, 硬盘 $\geq$ 1000G	无偏离	
		10.5.3	彩色液晶监视器 $\geq$ 20 吋	彩色液晶监视器 $\geq$ 20 吋	无偏离	
		10.5.4	彩色激光打印机：1 台	彩色激光打印机：1 台	无偏离	
		10.5.5	提供联入医院 pacs 接口的费用	提供联入医院 pacs 接口的费用	无偏离	
		10.5.6	操作系统：正版 win7 专业版 64bit	操作系统：正版 win7 专业版 64bit	无偏离	
		11.	质保期： $\geq$ 48 个月	质保期： 48 个月	无偏离	

投标人授权代表签字：_____

投标人(盖章)：_____



附件6 商务条款偏离表

投标人名称：_北京胜云心康医疗科技有限公司_ 招标编号：_CEITCL-BJ10-1901009_

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1	所有商务条款号	所有招标商务条款	所有投标商务条款	无偏离

投标人授权代表签字：_____
投标人(盖章)：_____



编号:1 025314 88



营业执照

(副本)-1)

统一社会信用代码 91110107MA00739R1P

名称 北京胜云心康医疗科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼7层805
法定代表人 王胜利
注册资本 200万元
成立日期 2016年07月21日
营业期限 2016年07月21日至 2046年07月20日
经营范围

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;批发医疗器械II类:6807胸腔心血管外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用射线材料,6868医用塑料制品,6869医用塑料制品,6870软件,6883口腔科材料,销售医疗器械(限I类)、服装服饰、鞋帽、日用品、工艺品、建筑材料(不从事实体店经营)、机械产品、电子产品、通讯设备、文化用品、计算机、软件及辅助设备、五金交电(不从事实体店经营)、日用品、卫生间用具;计算机技术培训(不得面向全国招生);会议服务;企业管理咨询;旅游信息咨询;酒店管理;房屋租赁;汽车租赁(不含九座以上乘用车);租赁计算机、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 8 月 9 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 京石食药监械经营备20160091号

企业名称	北京胜云心康医疗科技有限公司
法定代表人	王胜利
企业负责人	王胜利
经营方式	批发
住 所	北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼7层805
经营场所	北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼7层805
库房地址	***
经营范围	II类: 6807胸腔心血管外科手术器械, 6809泌尿肛肠外科手术器械, 6820普通诊察器械, 6821医用电子仪器设备, 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823医用超声仪器及有关设备, 6824医用激光仪器设备, 6825医用高频仪器设备, 6826物理治疗及康复设备, 6827中医器械, 6828医用磁共振设备, 6830医用X射线设备, 6831医用X射线附属设备及部件, 6832医用高能射线设备, 6833医用核素设备, 6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外), 6841医用化验和基础设备器具, 6845体外循环及血液处理设备, 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6855口腔科设备及器具, 6856病房护理设备及器具, 6857消毒和灭菌设备及器具, 6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6864医用卫生材料及敷料, 6865医用缝合材料及粘合剂, 6866医用高分子材料及制品, 6870软件, 6863口腔科材料***

备案部门(备案专用章)



附件7-4 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于(中国)的(北京胜云心康医疗科技有限公司)的在下面签字的(王胜利、总经理)代表本公司授权(北京胜云心康医疗科技有限公司)的在下面签字的(杨洋、销售经理)为本公司的合法代理人，就(北京市密云区中医医院医疗设备采购项目)的(动态心电分析系统、动态血压检测系统)投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2019 年 02 月 15 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字



被授权人签字

杨洋

公司盖章：

附：

被授权人姓名：杨洋

职 务：销售经理

详细通讯地址：北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼7层805

邮政编码：100043

传 真：010-88680699

电 话：010-88680699

附件7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时提供）

2、名称及概况：

(1) 制造商名称：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司

(2) 地址及邮编：上海市外高桥保税区意威路 96 号 1 幢

(3) 成立和注册日期：1892 年

(4) 主管部门：_____

(5) 企业性质：_____

(6) 法人代表：文智贤

(7) 职员人数：约 5.2 万人

一般工人：_____

技术人员：_____

(8) 近期资产负债表(到 2018 年 12 月 31 日止)

(1) 固定资产：50,518 百万美元

原值：50,518 百万美元

净值：41,425 百万美元

(2) 流动资金：157,058 百万美元

(3) 长期负债：197,858 百万美元

(4) 短期负债：81,580 百万美元

(5) 资金来源

自有资金：_____

银行贷款：_____

(6) 资金类型：_____

生产资金：_____

非生产资金：_____

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
通用电气医疗	MR、CT、XR、MQ 等	5000 万	5.2 万
集团所属工厂			

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

已有 127 年的历史，是目前世界上最大供应商之一

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址_____销售项目和数量

出口销售额：_____

5、近三年的年营业额：

年份 _____ 国内 _____ 出口 _____ 总额

6、有关开户银行的名称和地址：The Bank of New York, PO BOX 11402, New York, NY, 10286-1402

7、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



日期：2019年02月15日

制造商名称：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司

投标人授权代表(签字)： 陈明用

投标人授权代表的职务：销售经理

电话号：18701644735

制造商盖章：_____

传真号：001 203 3732211



附件7-6 经销商(作为代理)的资格声明 (投标人为经销商的填写)

1、名称及概况:

- (1) 投标人名称: 北京胜云心康医疗科技有限公司
- (2) 地址及邮编: 北京市石景山区石景山路乙 18 号院 3 号楼 7 层 805 100043
- (3) 成立和注册日期: 2016 年 07 月 21 日
- (4) 主管部门: 北京市工商行政管理局石景山分局
- (5) 公司性质: 自然人独资
- (6) 法人代表: 王胜利
- (7) 职员人数: 15 人
- (8) 近期资产负债表(到 2018 年 12 月 31 日止)
- 〈1〉 固定资产: 200 万元
- 原值: 200 万元
- 净值: 180 万元
- 〈2〉 流动资金: 150 万元
- 〈3〉 长期负债: 无
- 〈4〉 短期负债: 无
- 〈5〉 资金来源:
- 自有资金: 80 万
- 银行贷款: 无
- 〈6〉 资金类型: 人民币
- 商业性: _____
- 非商业性: _____



2、最近三年的年度总营业额:

年份	<u>2016</u>	国内	<u>100 万元</u>	出口	_____	总额
	<u>100 万元</u>		<u>2017</u>	<u>485 万元</u>		_____
	<u>485 万元</u>	<u>2018</u>	<u>600 万元</u>		<u>600 万元</u>	

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址:

名称和地址 _____ 销售的项目和数量

(1) 出口销售:

(2) 国内销售:

解放军 301 医院

2

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明:

制造厂名称和地址

制造项目和数量

深圳医疗器械(深圳)有限公司

无

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司

无

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话):

制造厂名称和地址

制造项目

无

无

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话):

合同号: 无

签字日期: 无

产品名称: 无

数量: 无

合同金额 无

7、有关开户银行的名称和地址: 中信银行石景山支行

8、投标人认为需要声明的其他情况 无

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: 2019 年 2 月 15 日

投标人授权代表(签字):

杨峰

投标人授权代表的职务: 销售经理

电话号: 18701644735

传真号: 010-88680699

公章:



附件7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时提供）

1、名称及概况：

- (1) 制造商名称：顺泰医疗器材(深圳)有限公司
- (2) 地址及邮编：深圳市宝安区观澜镇环观南路金雄达科技园 A 栋 2 楼
518110
- (3) 成立和注册日期：2008 年 2 月 25 日
- (4) 主管部门：_____
- (5) 企业性质：有限责任公司
- (6) 法人代表：SANDRA WISNIEWSKI
- (7) 职员人数：80
 一般工人：56
 技术人员：24
- (8) 近期资产负债表(到 2018 年 12 月 31 日止)
- (1) 固定资产：1500 万人民币
 原值：1500 万人民币
 净值：1200 万人民币
- (2) 流动资金：120 万
- (3) 长期负债：无
- (4) 短期负债：无
- (5) 资金来源
 自有资金：200 万
 银行贷款：无
- (6) 资金类型：_____
 生产资金：_____
 非生产资金：_____

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
<u>顺泰医疗器材</u> <u>(深圳) 有限公司</u>	<u>Oscar 2</u>	<u>5 万</u>	<u>80</u>

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

投入市场

名称和地址 顺泰医疗器材(深圳)有限公司, 深圳市宝安区观澜镇环观南路金雄达科技园 A 栋 2 楼 销售项目和数量

北京友谊医院 20

5、近三年的年营业额:

2016 80 万美元 8900 万美元 8980 万美元

2017 102 万美元 9800 万美元 9902 万美元

2018 120 万美元 12000 万美元 13200 万美元

6、有关开户银行的名称和地址：中国工商银行深圳市分行，深圳市宝安区

7、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



日期：2019 年 02 月 15 日

制造商名称: 顺泰医疗器材(深圳)有限公司

投标人授权代表(签字): 

投标人授权代表的职务: 销售经理

电话号: 18701644735

制造商盖章:

传真号: 0755-29588986

我们（通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司）是按（中国）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（中国（上海）自由贸易试验区意威路 96 号 1 幢）。兹指派按（中国）的法律正式成立的，主要营业地点设在（北京市石景山区石景山路乙 18 号院 3 号楼 7 层 805）的（北京胜云心康医疗科技有限公司）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- (1) 代表我方办理贵方第_____（CEITCL-BJ10-1901009）_____号投标邀请
要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
- (2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和
分别承担招标文件中所规定的义务。
- (3) 我方兹授予_____（北京胜云心康医疗科技有限公司）_____全权办理和
履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全
权。兹确认_____（北京胜云心康医疗科技有限公司）_____或其正式
授权代表依此合法地办理一切事宜。
- (4) 我方于_____2019_____年_____02_____月_____08_____日签署本文件，（北京胜云
心康医疗科技有限公司）于_____2019_____年_____02_____月_____09_____日接受此件，以此
为证。

签字人职务和部门 文智贤

签字人(签字) 

致：北京市密云区中医医院

(2) 代表我方办理贵方第 (CEITCL-BJ10-1901009) 号投标邀请
要求提供的由我方制造的货物的有关事宜, 并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 （北京胜云心康医疗科技有限公司） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （北京胜云心康医疗科技有限公司） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于 2019 年 02 月 15 日签署本文件, (北京胜云心康医疗科技有限公司) 于 2019 年 02 月 09 日接受此件, 以此为证。

制造商名称 (盖章)

签字人职务和部门 张丕治、销售总监

签字人（签字） 张永浩

中华人民共和国医疗器械注册证


注册证编号：国械注进20172216742

注册人名称	SunTech Medical Inc.
注册人住所	507 Airport Boulevard Suite 117 Morrisville, NC27560
生产地址	507 Airport Boulevard Suite 117 Morrisville, NC27560
代理人名称	顺泰医疗器材（深圳）有限公司
代理人住所	深圳市龙华新区观澜大和社区环观南路105号-15号2-3楼
产品名称	动态血压仪 Automatic Blood Pressure Measurement System
型号、规格	Oscar 2
结构及组成	该产品由血压仪主机、血压袖带、USB线缆、背包、背带及AccuWin Pro软件组成。其中，血压袖带包括成人环形袖带（25-35cm）、成人环形袖带（33-40cm）、无创血压袖带（儿童，臂围长度12-19cm）、无创血压袖带（小成人，臂围长度18-27cm）、无创血压袖带（加大号成人，臂围长度39-46cm）。
适用范围	该产品能够按照预定的程序连续多次测量成人及三岁以上小儿患者的收缩压、舒张压以及脉搏率。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：国家食品药品监督管理总局

批准日期：二〇一七年九月二十七日

有效期至：二〇二二年九月二十六日

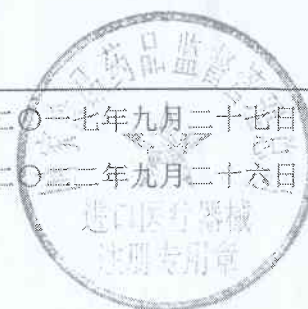

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号： 国械注进20152211588

注册人名称	GETEMED Medizin-und Informationstechnik AG
注册人住所	Oderstr. 77, 14513 Teltow, Germany
生产地址	Oderstr. 77, 14513 Teltow, Germany
代理人名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
代理人住所	上海市外高桥保税区意威路96号1幢
产品名称	动态心电记录仪 Holter ECG Digital Recorder
型号、规格	SEER 12
结构及组成	该产品由记录仪主机、患者电缆、动态心电适配电缆、导联线套装、电池仓、携带软袋、肩带、腰带组成，详见附件。
适用范围	该产品适用于可以从长期持续的心电图记录中受益的患者，尤其是患有心悸、胸痛、呼吸短促症状或需要实时监控判断当前心脏功能的患者。
附件	注册产品标准
其他内容	/
备注	

审批部门： 国家食品药品监督管理总局

批准日期： 二〇一五年五月二十五日
有效期至： 二〇二〇年五月二十四日





附页:

型号	规格	制造商
2014606-634	动态心电记录仪患者电缆, 圆形, AHA 颜色编码, 130 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-635	动态心电记录仪患者电缆, 圆形, IEC 颜色编码, 130 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-636	动态心电患者电缆, 扁平, AHA 颜色编码, 105 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-637	动态心电患者电缆, 扁平, IEC 颜色编码, 105 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-264	动态心电适配电缆, 4 通道 20 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-265	导联线套装, 4 通道, 30 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-266	导联线套装, 4 通道, 90 cm	Bernd Richter GmbH - 德国
2014606-472	电池仓适用于 1 块电池,	Constin GmbH - 德国
2014606-471	电池仓适用于 2 块电池	Constin GmbH - 德国
2014606-242	携带软袋包括肩带腰带	sk-spezialtaschen GmbH - 德国
2014606-297	携带软袋包括肩带腰带可放 2 块电池	sk-spezialtaschen GmbH - 德国
2014606-251	肩带	sk-spezialtaschen GmbH - 德国
2014606-250	腰带	sk-spezialtaschen GmbH - 德国

本页以下为空白。

售后服务承诺书

1、安装

设备到货后，我方按买方通知时间地点安排工程技术人员到达现场，在买方验收人员在场的情况下，清点货物，进行设备安装、调试及试运行，直至设备正常运行。

2、验收

设备安装后，使用方依据合同条款按国际和国家行业标准及院方使用要求进行质量验收。验收使用合格后双方签字生效。

3、培训

我方负责对买方技术人员、操作人员进行免费业务培训，培训内容包括设备操作、设备维护及维修等。

4、保修期：主机为设备安装调试验收使用合格后肆年。保修期内我方提供免费上门维修保养更换配件服务，由于操作不当引起的机器故障不在保修范围内。

5、维修

我方终身提供上门维修服务。设备出现问题，我方在接到买方电话通知后，立即提供电话指导，如无法当时解决，我方工程师将在指定时间内到达现场，负责设备的调换或者维修。我方保证拥有足够的耗材和零配件库，保证及时快捷的维修服务。

6、技术支持

维修服务地址：北京市石景山区万达广场 D 座 805 室

电话：010-88680699

传真：010-88680699

北京胜云心康医疗科技有限公司

